



ANALIZA BIAŁEK



100015373

Laboratorium Analizy

Klient: BIOPEPTA
Numer zamówienia: 100015373
Nazwa: BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: 260501
Data przyjęcia: 2026-06-16
Data rozpoczęcia: 2026-06-16
Data zakończenia: 2026-07-01

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Benzyl Alcohol	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiolce


Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Benzyl Alcohol	BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER	0,93%	-----
Test	Nazwa próbki	Wynik	
TYMC	BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER	<1,0x10 ¹ cfu/g	
TAMC	BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER	<1,0x10 ¹ cfu/g	
Obecność Escherichia Coli	BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER	NIE WYKRYTO	
Obecność Salmonella Spp.	BIOPEPTA BACTERIOSTATIC WATER	NIE WYKRYTO	

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3 µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H₂O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 0,93%. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 0,01%. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki

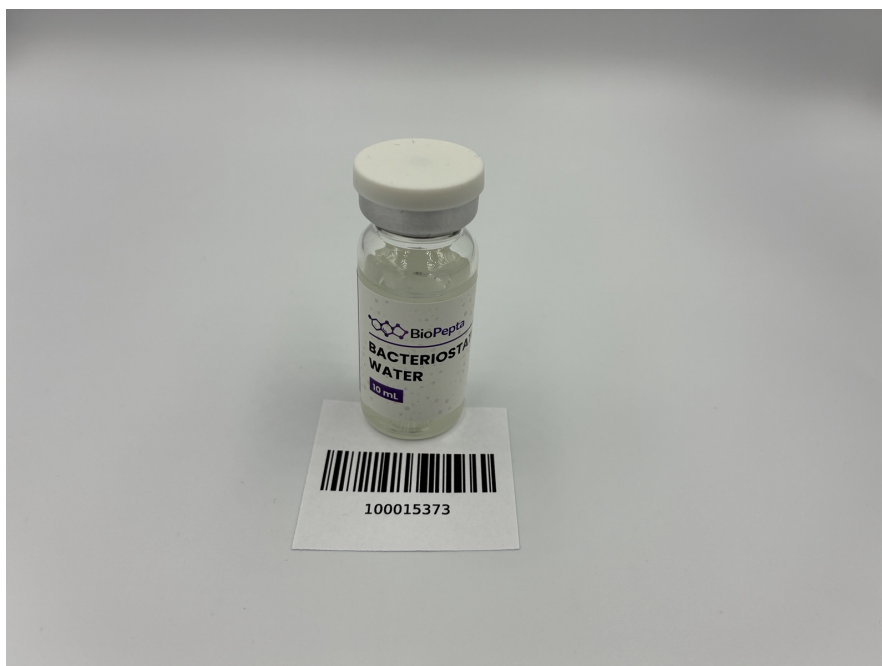

Hasło dostępu

73G4B2KU

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac




ANALIZA BIAŁEK



100015373

Chromatogram

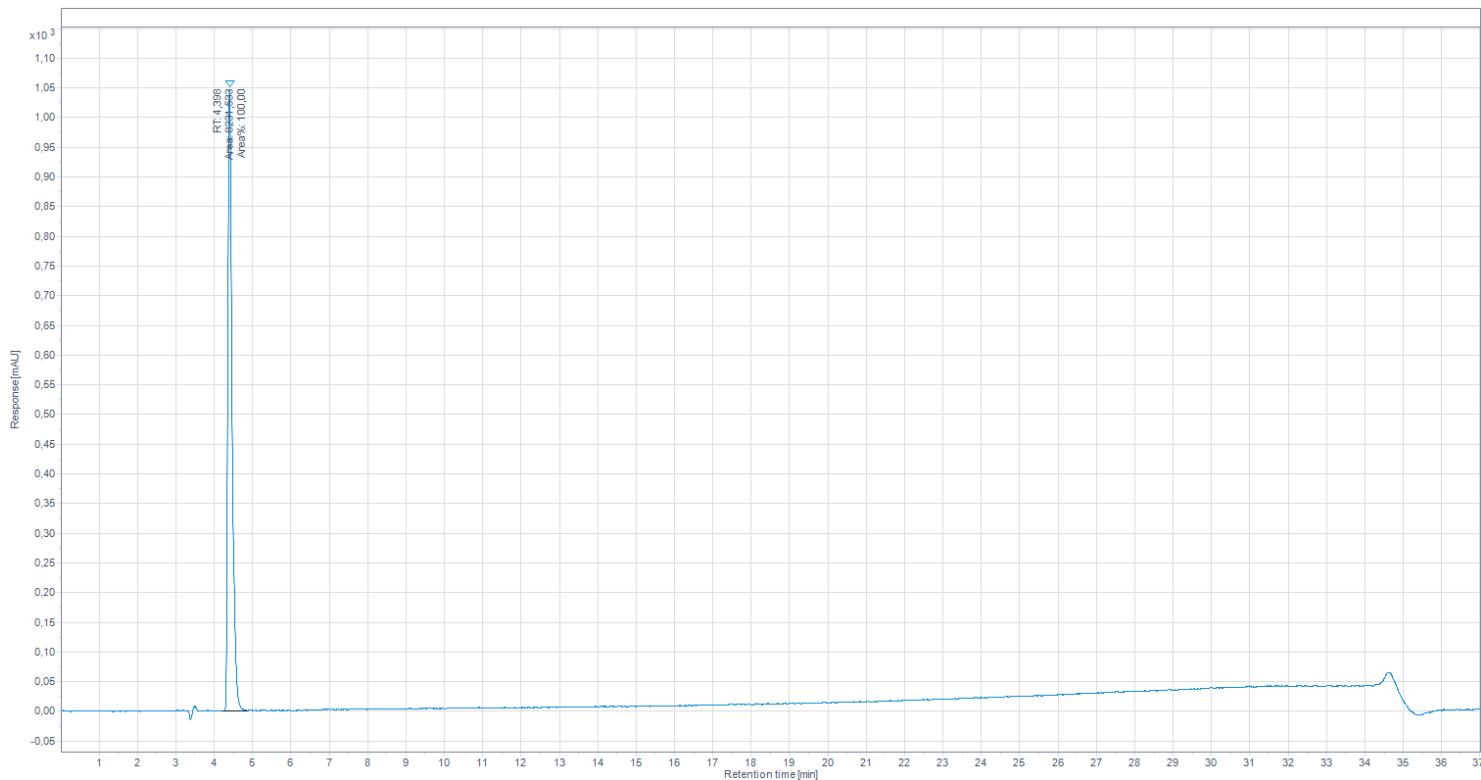

Metoda

Czas	H2O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	95%	5%
2min	95%	5%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

73G4B2KU

Analiza Białek sp. z o.o.

KRS: 0000966168

NIP: 8992922970

REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:

ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:

Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zajac